



17, Krylatskaya str., bld. 2
Krylatskoe municipal district, Moscow, 121614
Tel.: +7 495 139 26 89

121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2
Тел: +7 495 139 26 89

Исх. 2710/2025-ОП-НМ-338 от 27.10.2025

Фотографические изображения медицинского изделия

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная
УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

1. Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)



1.1 Глюкометр УанТач Верю Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)




1.2 Тест-полоски УанТач Верии (OneTouch Verio®) (10 шт. в уп.)



1.3 Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus)



1.4 Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) (10 шт. в уп.)

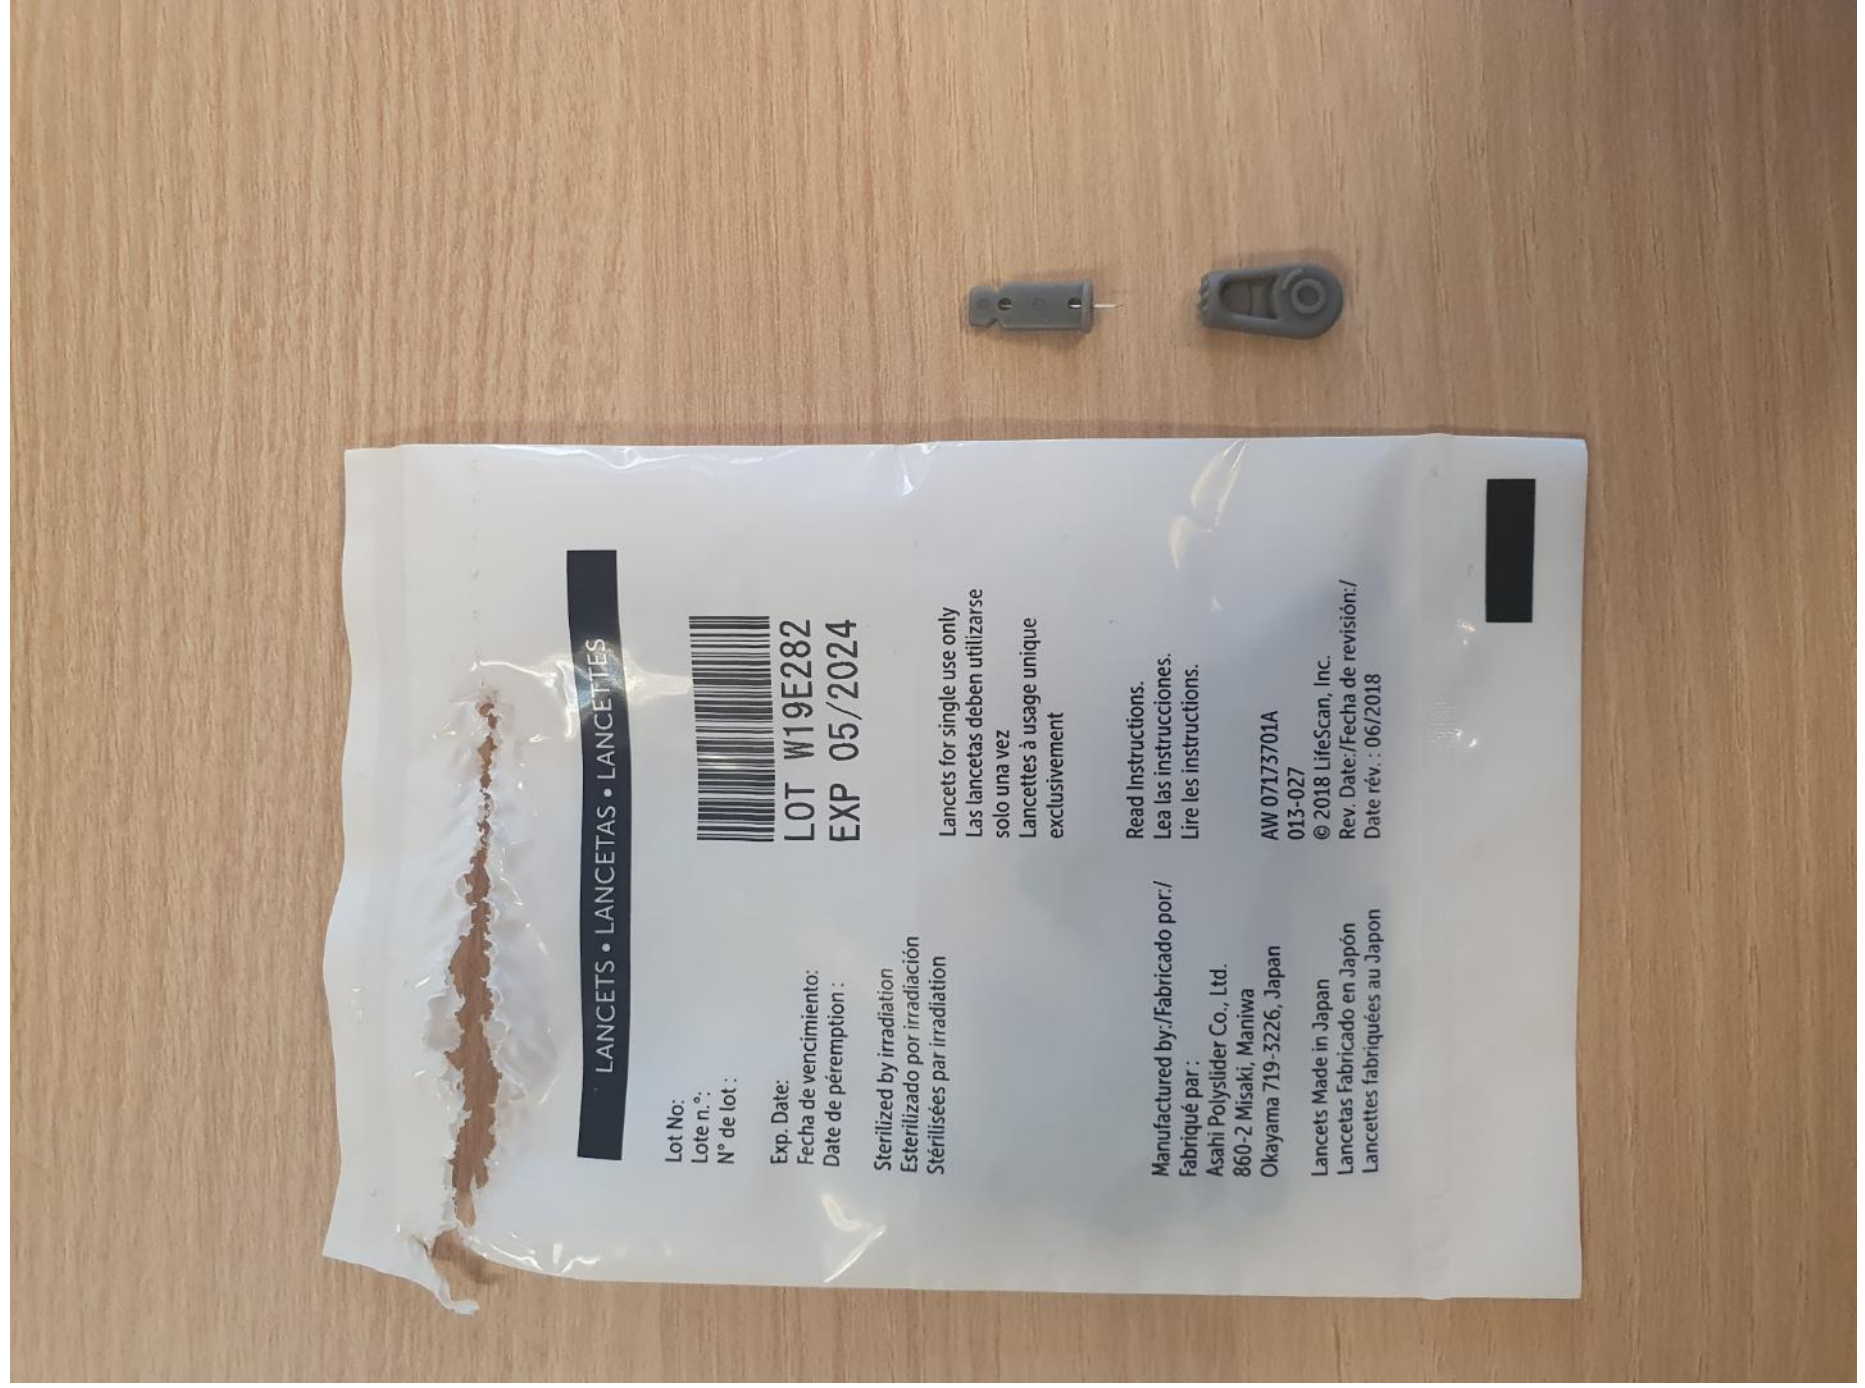

1.5 Футляр

















Принадлежность: Устройство для извлечения тест-полосок «стрип эджектор» (OneTouch® meter strip ejector) с инструкцией по применению устройства для извлечения тест-полосок «стрип эджектор» (OneTouch® meter strip ejector)



Маркировка Глюкометра УанТач Верио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

ONETOUCH
Verio Reflect®

Глюкометр

www.OneTouch.ru

IVD

Для диагностики *in vitro*.

Для самотестирования.

Ознакомьтесь с руководством
пользователя



0344

Дата редакции макета: 02/2020
© 2019-20 LifeScan IP Holdings, LLC
AW 07218701B



3 V  15 mA
Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария
AW 07218802A



Маркировка флакона с тест-полосками









После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 6 месяцев (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке)

дата утилизации:

Тест-полоски

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови (глюкометрами) серии OneTouch Verio® для количественного измерения уровня глюкозы (сахара) в свежих образцах цельной капиллярной крови, взятой из кончика пальца, и венозной крови. Для диагностики in vitro. Для самотестирования. Хранить тест-полоски во флаконе. Немедленно закрывать крышку. Не использовать повторно. Пределы температуры хранения от 5 °C до 30 °C. НЕ хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.







50 тест-полосок



Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт, IV2 3ED Инвернесс
Шотландия, Великобритания

Дата ред.: 08/2023
© 2018-2023 LifeScan IP Holdings, LLC



07036504A

AW 07036504A

SEAL

ONETOUCH® Delica® Plus

Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus)

10 стерильных ланцетов

Для использования с Ручкой для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) и Ручкой для прокалывания ВанТач Делика (OneTouch® Delica®)

Не использовать, если упаковка или защитная крышка отсутствует или повреждена. Только для одноразового использования. Не использовать повторно.

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53
(звонок по России бесплатный).

Посетите наш сайт www.onetouch.ru



Производитель:
Asahi Polyslider Co., Ltd.
Japan (Япония)

Уполномоченный
представитель в России:
ООО «ЛайфСкан Раша»
121614 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный
округ Крылатское,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2

OneTouch®
AW 07253704A
© 2018-2024 LifeScan
IP Holdings, LLC
Дата ред.: 06/2024
013-039

SEAL



LOT



STERILE R

0,32 MM

Маркировка Устройства для извлечения тест-полосок «стрип эджектор» (OneTouch® meter strip ejector)

